

BiWaze® Cough

QUICK GUIDE

En guide til opsætning og brug af din BiẆaze® hostemaskine, til en effektiv behandling.

THE GATEWAY FOR INOVATION | PORTA MEDICAL

Trin-for-trin opsætning

Indstil din maskine på 5 minutter

Følg disse enkle trin for at samle, tænde og placere maskinen til effektiv behandling.

1

Saml slangesættet
Tilslut patientport-adapteren sikkert til patientporten på maskinen. Fastgør Slangesættet til adapteren.

2

Tænd
Tænd for kontakten på bagsiden.
Tilslut om nødvendigt strømstikket.

3

Behandlingsskærmen
Skærmen viser den seneste behandling. Brug Drop Down menuen under „Auto“ for at se andre behandlinger.

4

Placer maskinen
Placer maskinen på en flad overflade indenfor patientens rækkevidde, under albueniveau, med luftindtagene frie. Maskinen selv-kalibrerer ved start



BiWaze® Cough oversigt.

Nøgle komponenter og funktioner.

Lær om de vigtigste funktioner, porte og kontroller på din BiWaze® hostemaskine for effektiv drift.

TOP OG FRONT PANEL

1. **Touchskærm**
Viser indstillinger, system status, behandlings indstillinger og logs. Indstillinger kan også modificeres via touchskærmen.

2. **Tilstands LED**
Lyser op med forskellige farver.

- Grøn = Manuel modus
- Blå = Auto modus
- Rød = Fejl eller nedlukning

3. **Patientport**
Tilslutningspunkt for patient-slangesættet. Brug en adapter For at tilslutte et 22 mm viral/bakterie filter.



SIDE PANEL

1. **Fodpedal port**
Port til valgfri fod pedal.

2. **Luftindtags filter**
Filtrerer den luft der kommer ind i maskinen til assisteret hoste behandling.

3. **HDMI-port**
Tillader ekstern visning af touch-skærmen via et HMDI-kabel.

4. **USB-porte**
USB-porte til data upload og download.
Forsigtig: Undgå at tilslutte ikke godkendte enheder.

5. **Køleventilator**
Afkøler hoved kontrol-boardet.

BAG PANEL

1. **Strømafbryder**
Tænder og slukker maskinen.

2. **Håndtag**
Til let at kunne bære maskinen.

3. **AC-strøm tilledning**
Tilslutning af AC strømstik for at give strøm til maskinen og oplade batteriet. Det røde lys indikerer at strømstikket er tilsluttet korrekt.

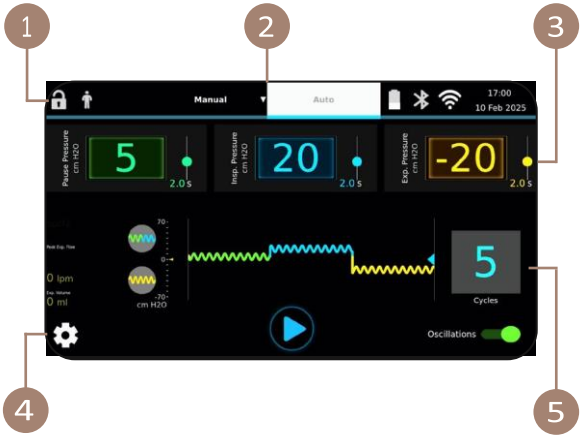

Navigering

Behandlingsskærm

Når BiWaze Cough systemet tændes, vil skærmen vise den sidste afsluttede behandling.
Nedenfor ses behandlingsskærmens komponenter.

1. **Låse status**
En rød lås begrænser plejerens adgangsfunktion, mens en grå lås tillader fuld adgang.

2. **Behandlings modus**
Auto
(Forudindstillet tryk/tider)
Manuel
(Bruger indstiller tryk/tider)

3. **Tryk og tidsindstilling**
Tryk og tidsværdier kan justeres ved at klikke på det pågældende parameter (Pause/Insp./Exp).

4. **Øvrige indstillinger**
Amplitude, flow, oscillations frekvens og trigger kan indstilles præcist og justeres individuelt.

5. **Cyclustæller**
Tæller gennemførte behandlings cyclusser for at spore fremskridt og sikre at målene nås.

Start behandling

Start, monitorer og juster behandlingsindstillinger til optimal behandling og patientkomfort.

AUTO BEHANDLING



1. Vælg Auto



2. Juster tryk og tider.



3. Juster antallet af cyklusser.



4. Start/stop behandling



5. Indstil oscillation
(Insp. / Eksp. / Begge)



6. Yderligere indstillinger for oscillation, flow & trigger

Yderligere information
Detaljeret information om de øvrige indstillinger kan tilgås via infosymbolet øverst til venstre.

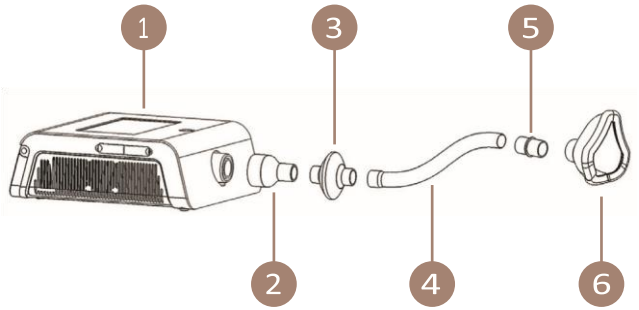

Klargøring af slangesæt

Konfigurer patientens slangesæt.

FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLD

Saml komponenterne 2-6 som vist på billedet og tilslut hele slangesættet til maskinen.

1. Selve hostemaskinen
2. Patient port adapter
3. Viral/Bakterie filter
4. Respirationsslange
5. Adapter
6. Maske

Patient tilslutning
Lækager ved patienttilslutningen kan reducere behandlingens effekt.

En omplacerings procedure kan være nødvendig for at forhindre lækage ved masken.

Følg altid din behandlers ordinerede behandlingsprotokol.

Rengør og vedligehold din maskine

Følg disse trin for korrekt at rengøre, inspicere og vedligeholde din maskine for at sikre en sikker og effektiv behandling.

TRIN-FOR-TRIN INSTRUKTIONER

1. Sluk for strømmen og tag stikket ud af kontakten. Træk stikket ud af maskinen.
2. Frakobl slangesættet.
3. Rengør ydersiden, patientport-adapteren og net ledningen med et godkendt rengøringsmiddel (se brugervejledning BC21084). Lad alt tørre helt, før du tilslutter det igen.
4. Frakobl alle slangesættets komponenter: filter, slange og maske/trach konnekter.
5. Undersøg filteret og kassér det, hvis det er beskadiget af sekret eller fugt. Hvis det ikke er beskadiget, skal du forsigtigt tørre det udvendige af med et godkendt rengøringsmiddel og læg det til side. Vask ikke virus-/bakteriefilteret.
6. Vask slangen, adapteren og masken/trachadapteren med varmt sæbevand.
7. Lad alle dele lufttørre helt før genbrug. Udskift slangesættet efter 30 dage eller 90 cyklusser. Kassér ikke patientportadapteren.

FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLDELSE

Ingen rutinemæssig service nødvendig. Enheden kalibrerer sig selv ved hver opstart.