Information omkring rengøring af sekretbeholder til LC27 inkl. overløbsbeskyttelse

Rengøring Sekretbeholder (inkl. overløbsbeskyttelse)

Tøm sekretbeholderen mindst én gang dagligt, og skyl det grundigt med rent vand. Rengør det om muligt med et mildt rengøringsmiddel, og skyl det derefter med rent vand.

Anbefaling: Inden sugning påbegyndes, fyldes der lidt vand (ca. 10-20 ml) i sekretbeholdersystemet. Dette forhindrer, at sekretet tørrer ud.

- Sekretbeholderen kan koges (maks. 30 cyklusser).
- Sekretbeholderen er egnet til rengøring i opvaskemaskine.
- Når apparatet skiftes til en anden patient, skal sekretbeholderen udskiftes.
- Ved hyppig brug og desinfektion anbefaler ATMOS at udskifte sekretbeholderen mindst hver 3. måned.
- Kontroller den sorte tætningsring i sekretbeholderens låg for snavs eller beskadigelse. Rengør tætningsringen, eller udskift den.
- Kontroller, at den sorte tætningsring sidder korrekt i sekretbeholderens låg efter rengøring. Hvis tætningsringen ikke er i låget på sekretbeholderen, skal tætningsringen sættes i igen.
- Kontroller, at den mekaniske overløbsbeskyttelse er monteret korrekt i låget på sekretbeholderen efter rengøring. Sørg for, at flydekuglen er til stede i den mekaniske overløbsbeskyttelse.

Særligt omkring overløbsbeskyttelse:

Fjern låget til sekretbeholderen.

Fjern den mekaniske overløbsbeskyttelse fra låget til sekretbeholderen til enkeltpatienter, og skub derefter flydekuglen ud.

Rengør beholderen efter hver brug.

Illustration af overløbsbeskyttelse med flydekugle:

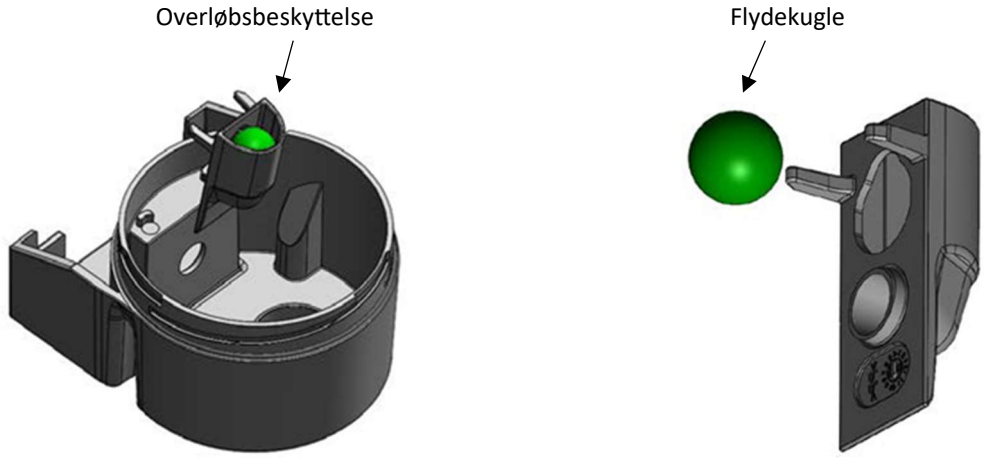

04/2026

ekkoMED
Medicinsk udstyr og tilbehør

Ekkomed A/S
Vagn Kloses Vej 14 7500 Holstebro
Tlf: 9740 6870, info@ekkomed.dk **www.ekkomed.dk**